

# Minimizar los daños al endoscopio

Olympus se compromete a ayudarle a aprovechar al máximo su equipo de endoscopía. La información mostrada a continuación tiene como objetivo destacar las causas comunes de daño a los endoscopios y proporcionar consejos para reducir las reparaciones. De esta forma puede mantener su equipo funcionando a un nivel óptimo.

## ¿QUÉ NO HACER?

Ejercer presión excesiva sobre el tubo de inserción en la base del endoscopio.



Forzar accesorios a través del canal de biopsia.



Olvidar conectar el adaptador de limpieza del canal de aire/agua durante la pre-limpieza.




## CONSECUENCIA

Deformación del tubo de inserción; daño a los componentes internos.



Perforación del canal de biopsia; invasión de líquidos.

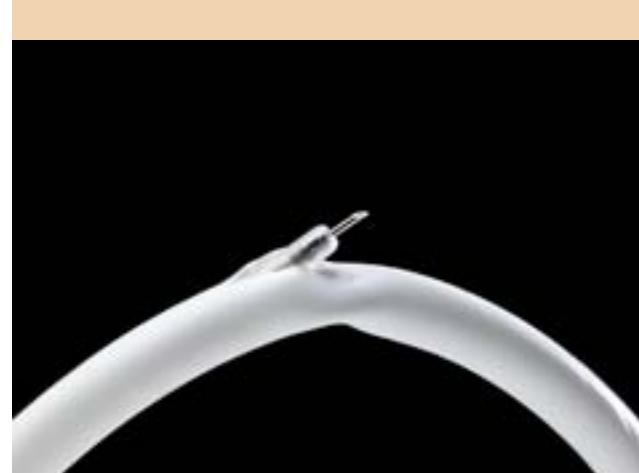

Obstrucción la boquilla de aire/agua, flujo deficiente de aire/agua.



## RECOMENDACIÓN

Evite doblar el tubo de inserción a menos de 10 cm de la unión de la funda del endoscopio.



Revise los accesorios antes del procedimiento y utilice movimientos lentos y cortos al insertar accesorios en el canal de biopsia.



Use siempre el adaptador de limpieza del canal de aire/agua durante la pre-limpieza.



Para obtener asistencia inmediata con respecto a la reparación o el servicio de sus endoscopios Olympus,  
llame al 800-848-9024 y seleccione la opción n°3  
[www.medical.olympusamerica.com/serviceportal](http://www.medical.olympusamerica.com/serviceportal)

**OLYMPUS®**

LCR57654V01